

Ekspertyza medyczna dotycząca energii: Kwiecień 2020 – urządzenie BUBBLE

Streszczenie kluczowych zagadnień wykładu Dr. med. Manfreda Doeppa, wykład ten jest dostępny do obejrzenia w formie filmu video.

Dr. med. Manfred Doepp

- 1999 Założyciel i członek Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Energetycznej, Wiceprezes.
- Wykazano, że dr Doepp stworzył najwięcej medycznych ekspertyz dot. energii na świecie.
- Ocena została stworzona przy użyciu TimeWaver Cardio. Dr Doepp jest twórcą tego znanego na całym świecie systemu.
- Dr.med. Manfred Doepp uznawany jest za światowego lidera w kwestii pomiaru, oceny i terapeutycznego wdrażania medycyny informacyjnej.
- Medycyna informacyjna to medycyna teraźniejszości oraz przyszłości.

Podsumowanie wykładu/Treść:

Częstotliwość oraz medycyna informacyjna

- Częstotliwości Schumana są podstawą dla całego organizmu, a w szczególności dla mózgu.
- Częstotliwości Schumanna coraz bardziej wymykają się spod kontroli, gdyż są masowo zakłócane przez wiele fal radiowych.
- Nadajniki satelitarne 5G mogą być skuteczną bronią wojskową, bezpośrednio skierowaną na komórki.
- Coraz trudniej jest prowadzić zdrowy tryb życia. Liczba zdrowych ludzi zmniejsza się od 45 lat (tak długo dr Doepp samodzielnie gromadzi dane!), pojawia się wegetatywna niestabilność (dystonia), błędny i współczulny system nerwowy przestają rytmicznie współpracować. Na przykład mitochondriopatia, autoagresja przeciwko własnym molekułom ciała, alergie na białka wielkocząsteczkowe i wiele innych są oznakami, że cały organizm jest coraz bardziej rozregulowany.
- Wszystko, co powinno funkcjonować autonomicznie, przestaje działać i zaczyna chorować: układ odpornościowy, autonomiczny układ nerwowy, układ krwionośny, układ trawienny, itd.
- Bardzo dobrze, że jest urządzenie, które przywraca Częstotliwość Schumanna 8 Hz w przebiegu analogowym fal (sinusoidalnym).
- Prostokątne krzywe cyfrowe wywołują stres w każdej komórce (np. dowolny system radiowy, telefon komórkowy, satelita, kuchenka indukcyjna, itp.) Dzieje się tak dlatego, że komórki potrzebują analogowych impulsów o częstotliwości 8 Hz, aby móc się zregenerować.

Pomiar oraz sporządzenie ekspertyzy z urządzeniem kardio:

- Chaos i sztywność to stany patologiczne, pomiędzy którymi panuje zmienność.
- Nieład = chaos jest funkcją błędnika (relaksacja).
- Porządek = sztywność jest funkcją współczulnego układu nerwowego (napięcie).
- Wegetatywny układ nerwowy powinien wahać się między napięciem a rozluźnieniem. Jest to stan prawidłowy. Do opisanie stanu zdrowia należy zastosować zasadę złotego podziału. Nie jest to średnia arytmetyczna, ale opisuje zmienność.

Pomiar:

- Pomiar przeprowadzono z udziałem 10 badanych.
- Oczekiwania na poziomie wyjściowym zostały jasno zweryfikowane: połowa z badanych była wyraźnie zastygła. Konsekwentny brak zmienności.
- Drugi pomiar z użyciem BUBBLE; układ wegetatywny ponownie wraca do normy. Innymi słowy, wszyscy badani osiągnęli ponownie złoty stosunek napięcia i odprężenia. Wskaźnik stresu oraz tendencja do wyczerpania zostały unormowane.
- 10 badanych poddano testowi istotności stosując Test T Studenta*.
- W badaniu uzyskano wynik niezwykle istotny: wyraźna nieprawidłowość bez użycia BUBBLE, idealna normalność z użyciem BUBBLE.

Ekspertyza wraz z oceną znajdują się w załączniku.

Dr. Doepp poinformował, że sam nosi to urządzenie. Jego zalecenia są następujące:

1. W celu wzmocnienia systemu immunologicznego, urządzenie należy nosić bezpośrednio przed grasicą.
2. Natomiast w celu wyregulowania trawienia, metabolizmu i wagi, należy je nosić bezpośrednio przed splotem słonecznym (nieco niżej niż grasicą).

Dr. Doepp oraz jego małżonka, Ornella Manca Doepp, są dosłownie zachwyceni urządzeniem BUBBLE.

Wniosek: urządzenie jest skuteczne, działa znakomicie, działa fizjologicznie i pracuje z takimi rodzajami fal, jakich organizm potrzebuje do przywrócenia normalności. W ten sposób zostaje przywrócona rezyliencja w ciele.

* Test t jest testem hipotezy statystycznej, w którym statystyka testowa podąża za rozkładem t studenta przyjmując hipotezę zerową. Test t najczęściej stosowany jest, kiedy statystyka testu miałaby rozkład normalny, gdyby znana była wartość składnika skalującego w statystyce.

- 1/6

Dr med. Manfred Doepp
Hauptstr. 17
CH 9030 Abtwil
Lekarz prowadzący www.holisticcenter.ch

20/03/2020

Ekspertyza medyczna dot. energii

Na temat biologicznych efektów urządzenia i-like BUBBLE ze strony CENTROPIX
(6 stron)

Miejscowość:

CH 9030 Abtwil

Termin Pomiaru:

Marzec 2020


Badani: dziesięć osób, różniących się pod względem wieku i płci

Metoda pomiarowa: Zmienność rytmu serca (HRV) jako moduł TimeWaver® Cardio

Procedura: osoby były poddane badaniu zarówno z zawieszonym wokół szyi urządzeniem BUBBLE, jak i bez niego

Poniżej przedstawiono typowe wyniki badania na przykładzie dwóch osób.

Osoba testowana nr 1 (bez użycia BUBBLE)

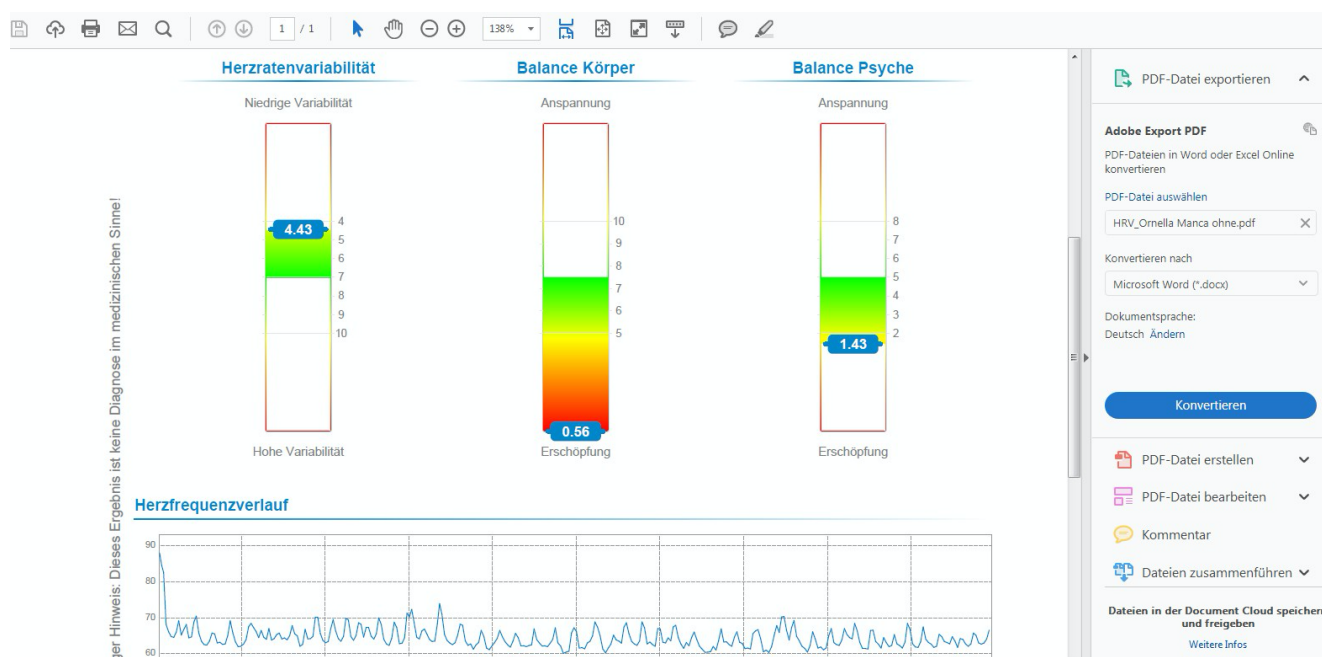

Wyniki pomiarów bez użycia BUBBLE, grafika nr 1 Ocena: Stwierdzenie Stanu Wyczerpania


- 2/6

Osoba testowana nr 1 (bez użycia BUBBLE)



Pomiary bez użycia BUBBLE, grafika nr 2 Ocena: Stwierdzenie stanu wyczerpania


Osoba testowana nr 1 (z użyciem BUBBLE jako zawieszki)

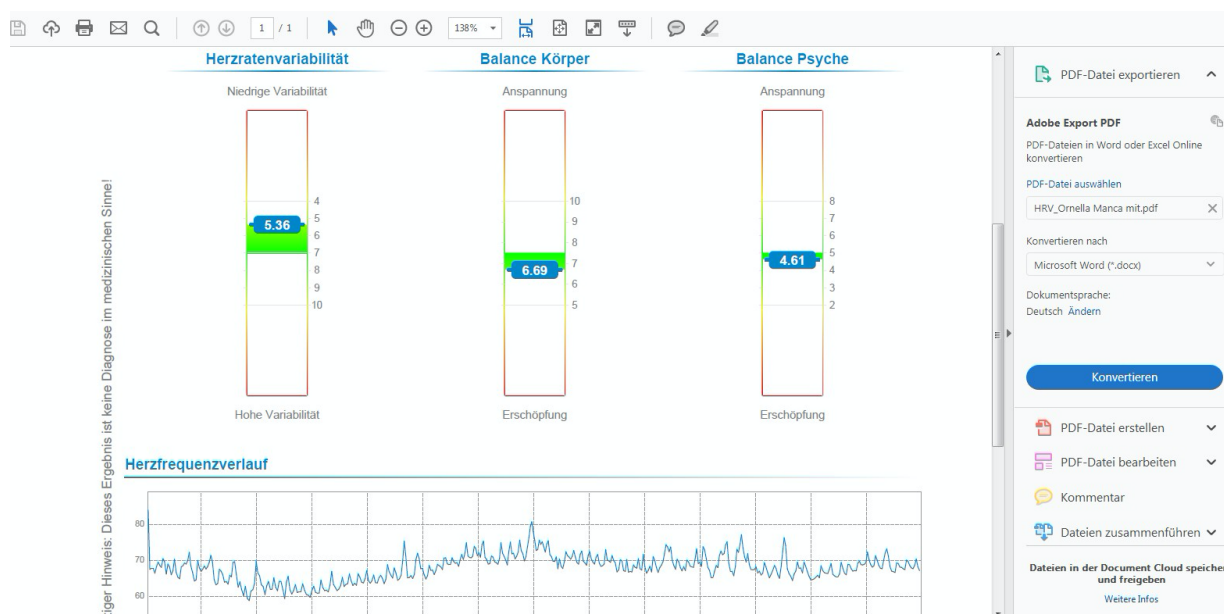

Pomiary z użyciem BUBBLE, grafika nr 3 Ocena: Wyniki w normie


- 2/6

Osoba testowana nr 1 (z użyciem BUBBLE jako zawieszki)

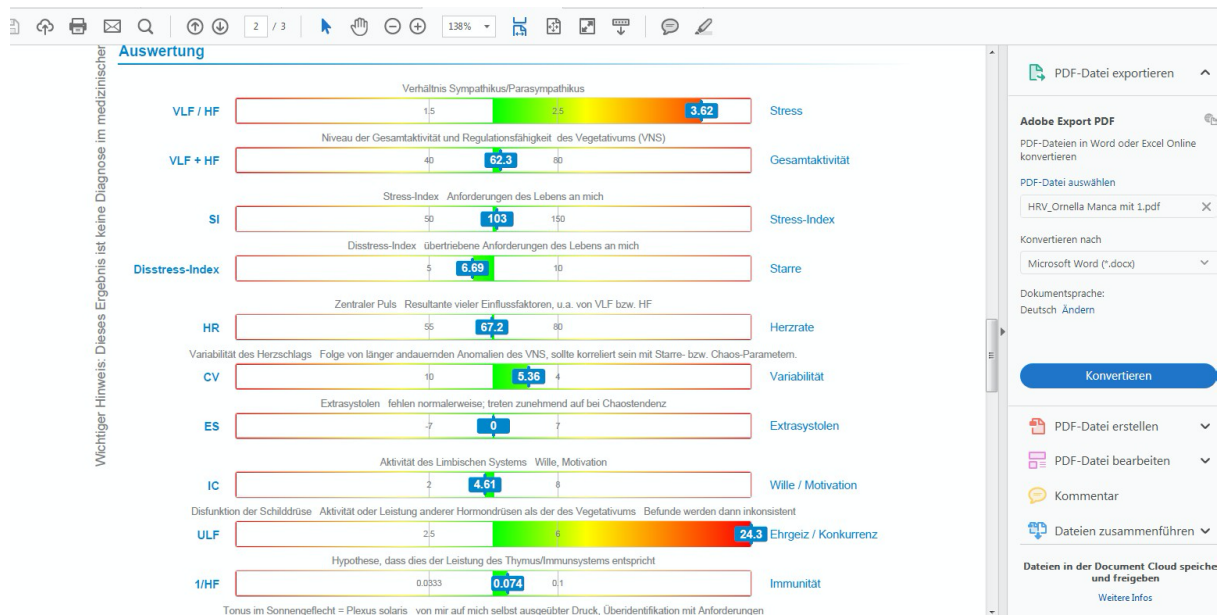

Pomiary z użyciem BUBBLE, grafika nr 4 Ocena: Brak wyczerpania, lekki stres


Osoba testowana nr 2 (bez użycia BUBBLE)

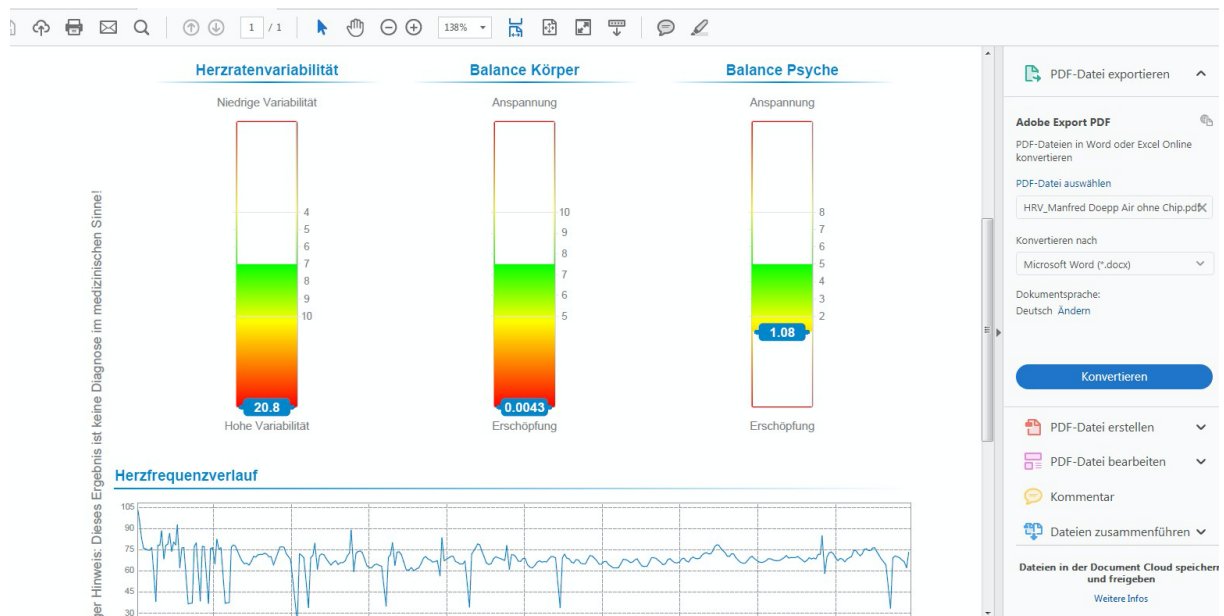

Pomiary bez użycia BUBBLE, grafika nr 5 Ocena: Stwierdzenie silnego wyczerpania


- 2/6

Osoba testowana nr 2 (bez użycia BUBBLE)

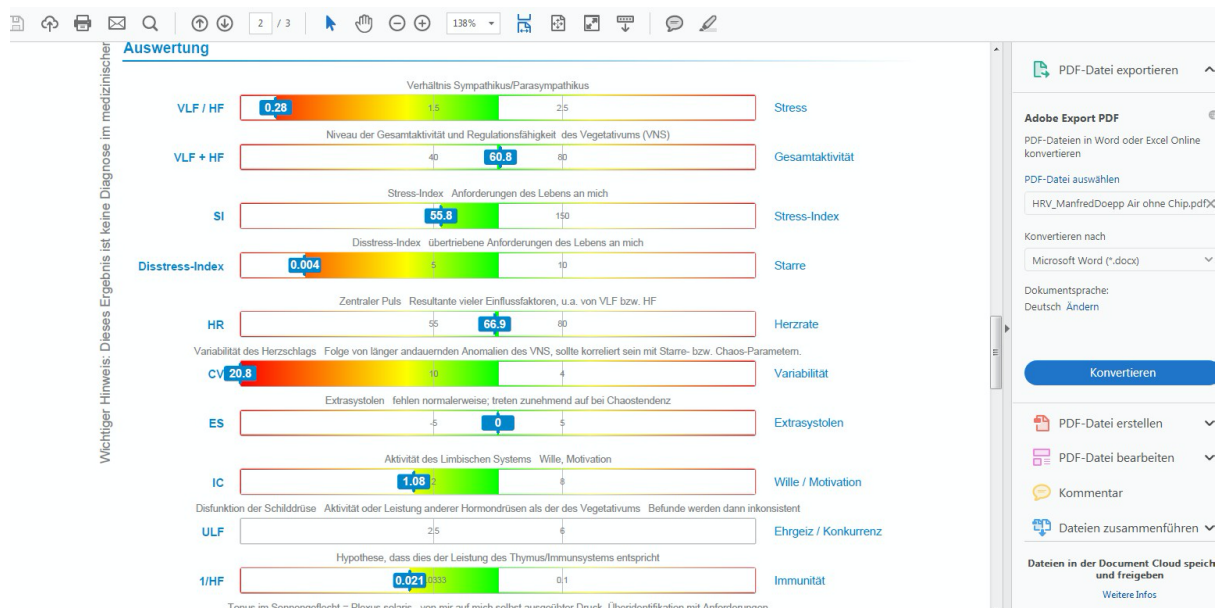

Pomiary bez użycia BUBBLE, grafika nr 6 Ocena: Stwierdzenie silnego wyczerpania

Osoba testowana nr 2 (z użyciem BUBBLE)

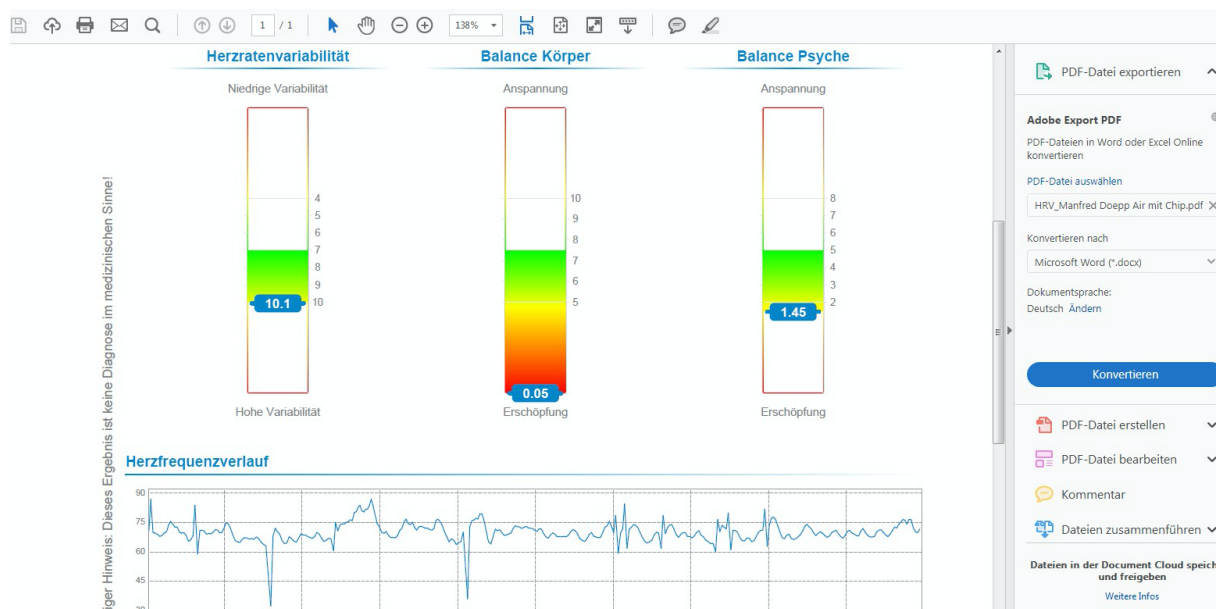

Pomiary z użyciem BUBBLE, grafika nr 7 Ocena: Poprawa stanu wyczerpania

- 2/6

Osoba testowana nr 2 (z użyciem BUBBLE)



Pomiary z użyciem BUBBLE, grafika nr 8 Ocena: Poprawa stanu wyczerpania

Statystyki:

Najważniejszym parametrem poddanym badaniu i ocenie była "równowaga ciała", wahająca się między napięciem (wysokim) a wyczerpaniem (bliskim zeru), z normą średnią 7,5; N = 10.

Test t-Studenta:

Grupa z BUBBLE: Średnia = 8,1, standardowe odchylenie =

5,3 Grupa bez BUBBLE: Średnia = 2,3, Standardowe

Odchylenie = 6,7

Wartość t = 3,28, poziom ufności = 100%, istotny dla p mniejszego niż 0,001 (niezwykle istotne)

Ocena:

Zbadano, czy oraz w jakim stopniu stosowanie urządzenia BUBBLE ze strony CENTROPIX zmienia wyniki badań układu hormonalnego (głównie nadnerczy) i autonomicznego układu nerwowego (szczególnie aktywność nerwu współczulnego); badanie przeprowadzono zarówno bez zawieszki BUBBLE, jak i z jej użyciem.

Jednoznacznie stwierdzono, że u badanych osób nastąpiła wyraźna poprawa wyników dominującego uczucia wyczerpania. Ponadto, badani jednomyślnie przyznali, że podczas noszenia zawieszki BUBBLE czuli się lepiej. Nie mieli ochoty jej zdjąć.

W związku z powyższym, zauważono wyraźnie pozytywny wpływ urządzenia BUBBLE na ważne kryteria biologiczne organizmu. Częstotliwość Schumanna 8 Hz w przebiegu analogowym fal jest ewidentnie zdolna do poprawy lub normalizacji istniejących odchyleń układu wegetatywnego od normy.

Dr med. Manfred

Doepp Podpis

